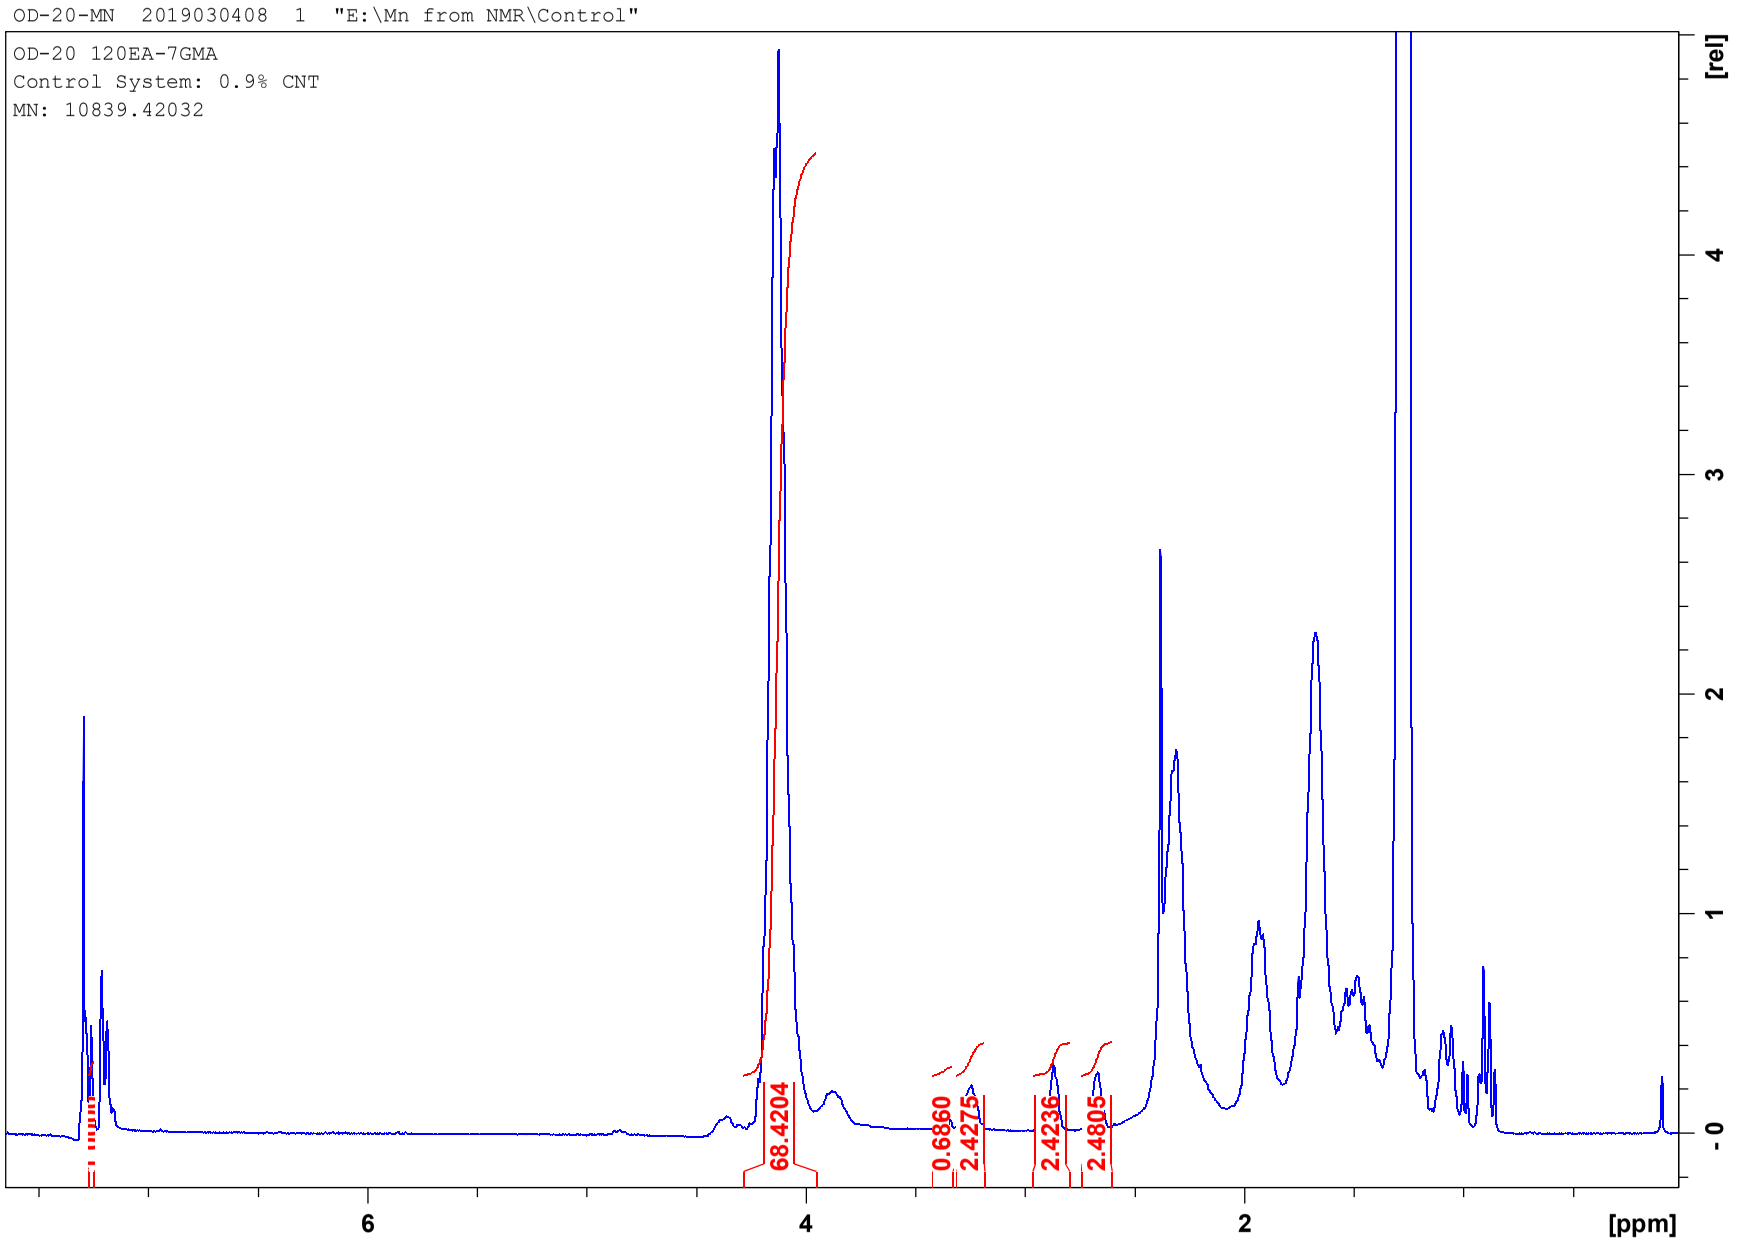
OD-20-MN 2019030408 1 "E:\Mn from NMR\Control"
OD-20 120EA-7GMA
Control System: 0.9% CNT
MN: 10839.42032
68.4204
0.6860
2.4275
2.4236
2.4805
6
4
2
[ppm]
[rel]
- 0
1
2
3
4